


fischer Dynamic-Anker FDA

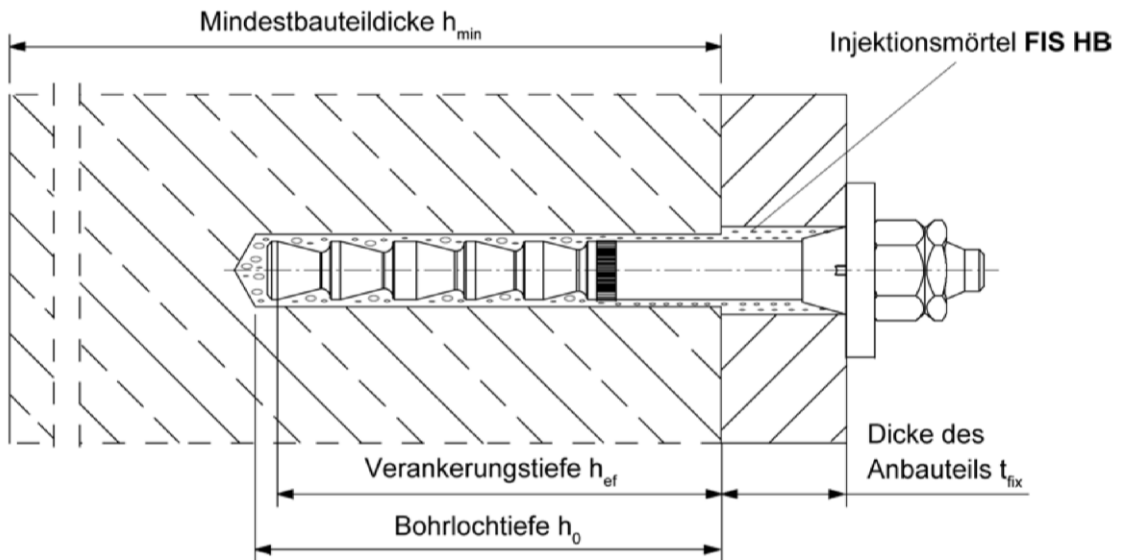

fischer Dynamic-Anker FDA

Einbauzustand

Anlage 1